


Multi-functional Sterilizer Wireless Charger User Manual

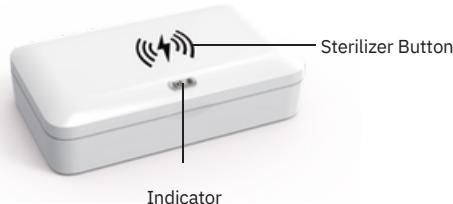

Wireless Charging

This product is a multi-functional mobile phone sterilization box with sterilization and wireless charging. There is no lithium battery inside this product. It is powered by the Type-C cable connecting to the power source.

Specification:

Wireless Output: DC 5V/1A (5W)

Input: DC 5V/2A (MAX)

Product Size(Outside): 210*120*55MM

Product Size(Inside): 180*100*40MM

UVC LED: 2 pcs

UVC LED Output Power: 2W (MAX)

UVC wavelength: 270nm-280nm


Wireless Charging Transmission Distance: 2-6MM

Material: ABS+PC

What's included:

1 x UV Sterilizer Case + Wireless Charger Cover

1 x Charging Cable

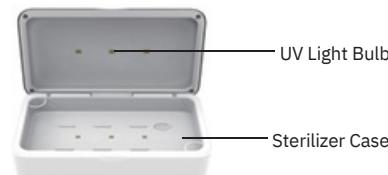

Using the disinfection function:

- Plug the case using the included type-c cable into the USB port of your adapter, the sterilizer indicator lamp turns to be red.
- Put anything which needed to be disinfected into the case, then close the cover. Make sure the case is closed.
- Press the button ,the disinfection function starts to work, the sterilizer indicator lamp turns to be blue. The disinfection function will automatically turn off after five minutes, the sterilizer indicator lamp turns to be red.
- Repeat the step while need more deeply clean.
- This product uses deep ultraviolet sterilization technology and uses LED UV lamp to kill bacteria on the items. Effectively kill bacteria such as Escherichia coli (E.Coli), Staphylococcus aureus(Staph) and Monilia albican (Candida albicans).etc. The sterilization effect is up to 99.9%.

Safety sensor & Protection

Built-in magnet sensor to protect user from UVC light.


The product CANNOT be powered on when the cover is not closed.

While the case is opened in the progress of sanitizing , Sanitizing will be stopped immediately. User needs to close the lid then manually press the button to restart the sanitizing from beginning. Could also press the button to stop the disinfection function.

CFB Cosmetics GmbH
Gannerstr. 8
50354 Hürth
Deutschland
Made in China



Multifunktionaler Sterilisator Benutzerhandbuch für das drahtlose Ladegerät

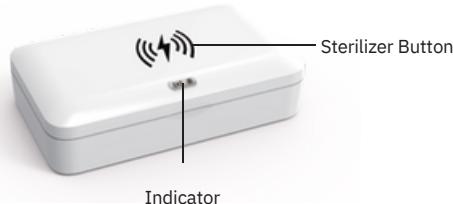

Wireless Charging

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine multifunktionale Mobiltelefon-Sterilisationsbox mit Sterilisation und drahtloser Aufladung. In diesem Produkt befindet sich keine Lithiumbatterie. Die Stromversorgung erfolgt über das Typ-C-Kabel, das an die Stromquelle angeschlossen wird.

Spezifikation:

Kabellose Ausgangsleistung: DC 5V/1A (5W)

Eingangsleistung: DC 5V/2A (MAX)

Produktgröße (Außen): 210*120*55MM

Produktgröße (Innen): 180*100*40MM

UVC LED: 2 Stück

UVC LED Ausgangsleistung: 2W (MAX)

UVC Wellenlänge: 270nm-280nm


Entfernung der drahtlosen Ladeübertragung: 2-6MM

Material: ABS+PC

Lieferumfang:

1 x Etui für UV-Sterilisator + Abdeckung für kabelloses Ladegerät

1 x Ladekabel

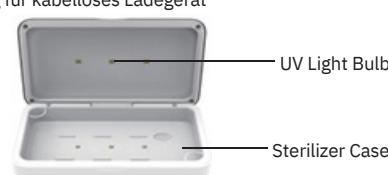

Verwendung der drahtlosen Aufladung:

- Schließen Sie das Etui mit dem mitgelieferten Kabel vom Typ C an den USB-Anschluss Ihres Adapters an. Die Anzeigelampe für das drahtlose Aufladen blinkt dreimal rot und grün und leuchtet dann rot auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon zum drahtlosen Aufladen kompatibel ist.
- Legen Sie Ihr für das drahtlose Aufladen aktiviertes Gerät auf die drahtlose Ladefläche, die Anzeigeleuchte für das drahtlose Aufladen leuchtet grün.

Erkennung von Fremdobjekten:

Beim drahtlosen Laden; wenn die Anzeigeleuchte für das drahtlose Laden abwechselnd rot und grün blinkt, ist das Gerät entweder KEIN drahtloses Ladegerät oder es befindet sich ein Gegenstand zwischen dem Gerät und der Ladefläche, der den Ladevorgang stört.

NTC-Schutz:

Wenn die Dauerbetriebstemperatur höher als 60 Grad Celsius ist, sinkt der elektrische Strom, und wenn die Temperatur 80 Grad Celsius überschreitet, wird das Ladegerät abgeschaltet. Die Anzeigeleuchte für das drahtlose Aufladen blinkt abwechselnd rot und grün. Wenn die Temperatur unter 60 Grad Celsius liegt, arbeitet das Ladegerät wieder normal.

Warnung:

Bitte beachten Sie die folgenden Überlegungen, da es sonst zu einer abnormalen Aufladung oder Desinfektion kommen kann.

1. Bitte legen Sie das Mobiltelefon in die Mitte des Ladebereichs (wie auf dem Bild gezeigt).
2. Der Messabstand beim drahtlosen Aufladen beträgt 2-6 mm. Wenn Sie das Mobiltelefon drahtlos aufladen, dann bitte nicht mit einer Schutzhülle mit einer Dicke von mehr als 3 mm.
3. Während des drahtlosen Aufladens dürfen sich innerhalb des Abstandsbereichs von 6 cm im Durchmesser vom Mittelpunkt auf der Rückseite des Mobiltelefons keine metallischen oder magnetischen Gegenstände befinden.
4. Je niedriger die Temperatur, desto schneller die Ladegeschwindigkeit. Die Ladegeschwindigkeit ist im Winter schneller als im Sommer.
5. Das Öffnen der Abdeckung während des Desinfektionsvorgangs stoppt automatisch die Desinfektion (UV-Lampen gehen aus), um ein Austreten von UV-Licht zu verhindern.
6. Achten Sie darauf, dass das Etui des UV-Sterilisators und die Abdeckung des kabellosen Ladegeräts wasserfest sind.
7. Überlasten Sie die Ausgangsleistung des Gerätes nicht. Überlastausgänge oberhalb der Nennleistung können zu einem Brand- oder Verletzungsrisiko führen.
8. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit aus.
9. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist bei Verwendung in der Nähe von Kindern eine sorgfältige Überwachung erforderlich.
10. Dieses Produkt ist mit einem Sicherheitsmechanismus ausgestattet, um das Risiko der Exposition gegenüber ultraviolettem Strahlung zu verringern. Der Zweck darf nicht verletzt werden.
11. Versuchen Sie NICHT, direkt auf die UVC-LEDS zu schauen, während das Gerät eingeschaltet ist. UV-Licht kann zu Reizungen der Augen und der Haut führen.
12. Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt zu modifizieren. Es wurde zur Eindämmung der UV-Belastung konzipiert.

Verwendung der Desinfektionsfunktion:

- Schließen Sie das Etui mit dem mitgelieferten Kabel vom Typ C an den USB-Anschluss Ihres Adapters an, die Sterilisator-Anzeigelampe leuchtet rot auf.
- Legen Sie alles, was desinfiziert werden muss, in das Etui und schließen Sie dann den Deckel. Stellen Sie sicher, dass das Etui geschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste , die Desinfektionsfunktion beginnt zu arbeiten, die Anzeigelampe des Sterilisators leuchtet blau. Die Desinfektionsfunktion schaltet sich nach fünf Minuten automatisch ab, die Anzeigelampe des Sterilisators leuchtet rot auf.
- Wiederholen Sie den Schritt, wenn Sie eine tiefere Reinigung benötigen.
- Dieses Produkt verwendet eine Tief-Ultraviolett-Sterilisationstechnologie und nutzt eine LED-UV-Lampe, um Bakterien auf den Artikeln abzutöten. Wirksame Abtötung von Bakterien wie Escherichia coli (E.Coli), Staphylococcus aureus (Staph) und Monilia albican (Candida albicans).etc. Der Sterilisationseffekt beträgt bis zu 99,9%.

Sicherheitssensor & Schutz

Eingegebauter Magnetsensor zum Schutz des Benutzers vor UVC-Licht.

Das Produkt kann NICHT eingeschaltet werden, wenn die Abdeckung nicht geschlossen ist.


Wenn das Etui während der Desinfektion geöffnet wird, wird die Desinfektion sofort

gestoppt. Der Benutzer muss den Deckel schließen und dann manuell die Taste drücken, um die Desinfektion von Anfang an zu starten. Sie könnten auch die Taste drücken, um die Desinfektionsfunktion zu beenden.

CFB Cosmetics GmbH
Gannerstr. 8
50354 Hürth
Deutschland
Made in China



Stérilisateur polyvalent Manuel d'utilisation du chargeur sans fil

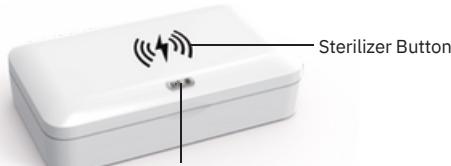

Wireless Charging Indicator

Ce produit est une boîte de stérilisation de téléphone portable polyvalente assurant une stérilisation et un chargement sans fil. Il n'y a pas de pile au lithium dans ce produit. Il est alimenté par le câble de Type C qui le relie à la source d'alimentation.

Spécifications:

Sortie sans fil : CC 5 V/1 A (5 W)

Entrée : CC 5 V/2 A (MAX)

Dimensions (extérieures) du produit : 210 x 120 x 55 mm

Dimensions (intérieures) du produit : 180 x 100 x 40 mm

LED UVC : 2 pièces

Puissance de sortie des LED UVC : 2 W (MAX)

Longueur d'onde UVC : 270 nm-280 nm


Distance de transmission de la charge sans fil : 2-6 mm

Matériaux : ABS+PC

Contenu de l'emballage:

1 x boîtier de stérilisation UV + couvercle de charge sans fil

1 x câble de charge

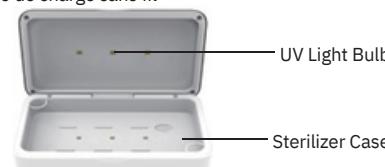

Utilisation de la fonction de désinfection:

- Branchez le boîtier à l'aide du câble de Type C fourni dans le port USB de votre adaptateur, le témoin lumineux du stérilisateur devient rouge.
- Mettez tout ce qui doit être désinfecté dans le boîtier, puis fermez le couvercle. Assurez-vous que le boîtier est fermé.
- Appuyez sur le bouton, la fonction de désinfection commence à fonctionner, le témoin lumineux du stérilisateur devient bleu. La fonction de désinfection s'éteint automatiquement au bout de cinq minutes, le témoin lumineux du stérilisateur devient rouge.
- Répétez l'opération si vous avez besoin d'un nettoyage plus en profondeur.
- Ce produit utilise une technologie de stérilisation par ultraviolets profonds et utilise une lampe UV à LED pour tuer les bactéries sur les objets. Tue efficacement les bactéries telles qu'Escherichia coli (E.Coli), Staphylococcus aureus (Staph) et Monilia albican (Candida albicans), etc.

L'effet de stérilisation atteint 99,9 %.

Capteur de sécurité et protection

Capteur magnétique intégré pour protéger l'utilisateur de la lumière UVC.


Le produit NE PEUT PAS être mis sous tension tant que le couvercle n'est pas fermé.

Si le boîtier est ouvert pendant le processus d'assainissement, l'assainissement s'arrête immédiatement. L'utilisateur doit fermer le couvercle puis appuyer manuellement sur le bouton pour redémarrer l'assainissement depuis le début. Vous pouvez également appuyer sur le bouton pour arrêter la fonction de désinfection.

CFB Cosmetics GmbH
Gannerstr. 8
50354 Hürth
Deutschland
Made in China



Multifunctionele Sterilisator Gebruikershandleiding Draadloze Oplader

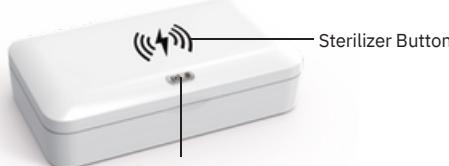

Wireless Charging Indicator

Dit product is een multifunctionele mobiele telefoon sterilisatiebox met functies voor sterlatisatie en draadloos opladen.

Dit product bevat geen lithiumbatterij. Het wordt gevoed door de Type-C-kabel die op de voedingsbron is aangesloten.

Specificatie:

Draadloze uitgang: DC 5V/1A (5W)

Ingang: DC 5V/2A (MAX)

Productgrootte(Buitenkant): 210*120*55MM

Productgrootte(Binnenkant): 180*100*40MM

UVC LED: 2 stuks

UVC LED Uitgangsvermogen: 2W (MAX)

UVC-golflengte: 270nm-280nm


Afstand voor Draadloos Opladen: 2-6MM

Materiaal: ABS+PC

Inbegrepen:

1 x Behuizing voor UV-sterilisator + Hoes Draadloze Lader

1 x Laadkabel

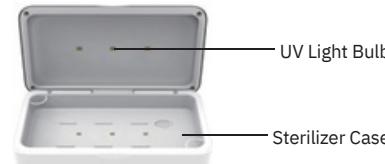

Het gebruik van de sterlisatiefunctie:

- Sluit de behuizing met de meegeleverde Type-C kabel aan op de USB-poort van uw adapter, het indicatielampje van de sterlisator wordt rood.
- Plaats het voorwerp dat u wilt steriliseren in de behuizing en sluit vervolgens het deksel. Controleer dat de behuizing dicht is.
- Druk op de knop, de sterlisatiefunctie begint te werken, het lampje van de sterlisator wordt blauw. De sterlisatiefunctie gaat na vijf minuten automatisch uit, het indicatielampje van de sterlisator wordt rood.
- Herhaal deze stappen indien grondigere sterlisatie vereist is.
- Dit product maakt gebruik van diepe ultraviolette sterlisatiertechnologie en maakt gebruik van LED UV-licht om bacteriën op de voorwerpen te doden. Doodt effectief bacteriën zoals Escherichia coli (E.Coli), Staphylococcus aureus (Staph) en Monilia albican (Candida albicans).etc. De sterlisatie is effectief tot 99,9%.

Veiligheidssensor & Bescherming

Ingebouwde magneetsensor om de gebruiker tegen UVC-licht.

Het product kan NIET worden ingeschakeld als het deksel niet gesloten is.

Als de behuizing wordt geopend tijdens de sterlisatie wordt het sterlisatieproces onmiddellijk beëindigd. De gebruiker dient het deksel te sluiten en vervolgens handmatig op de knop te drukken om de sterlisatie vanaf het begin opnieuw te starten.

Men kan ook op de knop drukken om het proces te onderbreken.



Utilisation de la charge sans fil:

- Branchez le boîtier à l'aide du câble de Type C fourni dans le port USB de votre adaptateur. Le témoin de charge sans fil clignote trois fois en rouge et vert, puis devient rouge.
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la charge sans fil.
- Placez votre appareil compatible avec la charge sans fil sur la surface de chargement sans fil, le témoin de charge sans fil devient vert.

Détection d'objets étrangers:

Lors de la charge sans fil, si le témoin de charge sans fil clignote en rouge et vert alternativement, l'appareil n'est PAS un dispositif compatible avec la charge sans fil ou il y a un objet entre l'appareil et la surface de chargement, ce qui interfère avec le processus de charge.

Protection NTC:

Lorsque la température de fonctionnement en continu est supérieure à 60 degrés Celsius, le courant électrique diminue et si la température dépasse 80 degrés Celsius, le chargeur s'éteint. Le témoin de charge sans fil clignote en rouge et vert alternativement.

Lorsque la température est inférieure à 60 degrés Celsius, le chargeur reprend son fonctionnement normal.

Attention:

Veuillez prêter attention aux considérations suivantes, faute de quoi un chargement ou une désinfection anormale peut survenir.

1. Veuillez placer le téléphone portable au centre de la zone de chargement (comme indiqué sur l'image).
2. La distance de détection du chargement sans fil est de 2 à 6 mm. En chargeant le téléphone portable sans fil, veuillez ne pas assembler le boîtier de protection avec une épaisseur de plus de 3 mm.
3. Pendant le chargement sans fil, il ne doit y avoir aucun objet métallique ou magnétique à une distance de 6 cm de diamètre par rapport au point central à l'arrière du téléphone portable.
4. Plus la température est basse, plus la vitesse de chargement est rapide. La vitesse de chargement est plus rapide en hiver qu'en été.
5. Au cours du processus de désinfection, l'ouverture du couvercle arrête automatiquement la désinfection (les lampes UV s'éteignent) pour éviter les fuites d'UV, pour restériliser, appuyez à nouveau sur le bouton.
6. Faites attention à l'étanchéité du boîtier du stérilisateur UV et du couvercle de chargement sans fil.
7. N'utilisez pas l'appareil au-delà de sa puissance nominale. Une sortie en surcharge supérieure à la valeur nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
8. N'exposez pas l'appareil à l'humidité.
9. Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité d'enfants.
10. Ce produit est doté d'un mécanisme de sécurité visant à réduire le risque d'exposition à un rayonnement ultraviolet. N'allez pas à l'encontre de son objectif.
11. N'essayez pas de regarder directement les LED à UVC lorsque l'appareil est allumé. La lumière UV peut être irritante pour les yeux et la peau.
12. N'essayez PAS de modifier ce produit. Il a été conçu pour contenir l'exposition aux UV.



Het gebruik van de draadloze oplader:

- Sluit de behuizing met de meegeleverde Type-C kabel aan op de USB-poort van uw adapter. Het lampje van de draadloze laadindicator knippert drie keer rood en groen en wordt dan rood.
- Controleer dat uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Leg uw apparaat op het draadloze oplaadoppervlak, het draadloze oplaadindicatielampje wordt groen.

Detectie van Vreemde Voorwerpen:

Bij draadloos opladen; als het indicatorlampje voor draadloos opladen rood en groen knippert, is het apparaat ofwel GEEN draadloos oplaadapparaat of is er een object tussen het apparaat en het oplaadoppervlak dat het oplaadproces belemmt.

NTC-bescherming:

Wanneer de continue werktemperatuur hoger is dan 60 graden Celsius, neemt de elektrische stroom af en als de temperatuur hoger is dan 80 graden Celsius, wordt de lader uitgeschakeld. Het draadloze oplaadindicatielampje knippert afwisselend rood en groen.

Wanneer de temperatuur onder de 60 graden Celsius is, werkt de lader weer normaal.

Waarschuwing:

Let op de volgende overwegingen, anders kan het leiden tot abnormaal opladen of steriliseren.

1. Plaats de mobiele telefoon in het midden van het oplaadgebied (zoals weergegeven in de afbeelding).
2. De detectieafstand voor draadloos opladen is 2-6 mm. Wanneer u de mobiele telefoon draadloos oplaat, gebruik dan geen beschermhoes met een dikte van meer dan 3mm.
3. Tijdens het draadloos opladen mogen er geen metalen of magnetische voorwerpen binnen het bereik van 6 cm diameter van het middelpunt op de achterkant van de mobiele telefoon zijn.
4. Hoe lager de temperatuur, hoe sneller de laadsnelheid. De laadsnelheid is sneller in de winter dan in de zomer.
5. Als het deksel wordt geopend tijdens het sterlisatieproces stopt het proces automatisch (UV-lichten gaan uit) om het lekken van UV te voorkomen. Druk opnieuw op de knop om te hervatten.
6. Let op de waterdichtheid van de behuizing van de UV-sterilisator en het deksel van de draadloze oplader.
7. Gebruik het apparaat niet in overschrijding van het nominale vermogen. Overbelaste uitgangen boven het nominale vermogen kunnen leiden tot brand of letsel.
8. Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
9. Om het risico op verwondingen te beperken is nauwlettend toezicht vereist wanneer het product wordt gebruikt in de nabijheid van kinderen.
10. Dit product heeft een veiligheidsmechanisme om het risico van blootstelling aan UV te voorkomen. Houd hier rekening mee.
11. Probeer NIET direct in de UVC-LEDs te kijken terwijl het apparaat in werking is. UV-light kan de huid en ogen irriteren.
12. Probeer dit product NIET aan te passen. Het is ontworpen om UV-blootstelling te voorkomen.

CFB Cosmetics GmbH
Gannerstr. 8
50354 Hürth
Deutschland
Made in China

